


ザ・ベストイメージング優秀作品

第4回 2011年度

最優秀賞

塩澤 克彦 (日本大学駿河台病院)

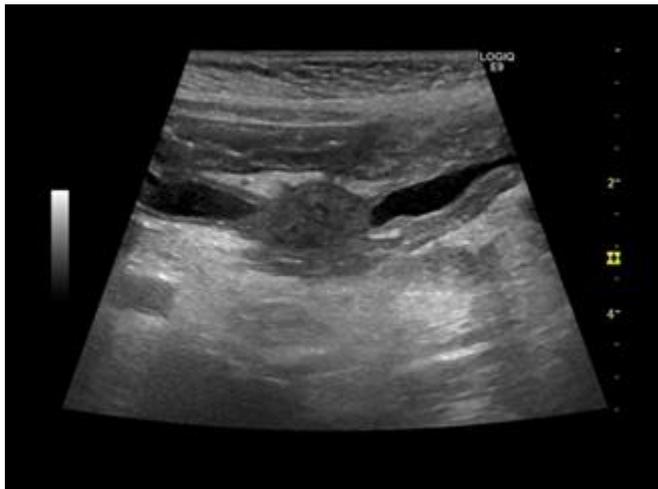

診断名 : 総胆管腫瘍

使用機種 : GE ヘルスケア LOGIQ E9


周波数 : 9.0 MHz

コメント (術者の一言)

閉塞部の腫瘍とその上部・下部の胆管が綺麗に描出出来ました。

特別賞

滝内 直二 (東京臨海病院)

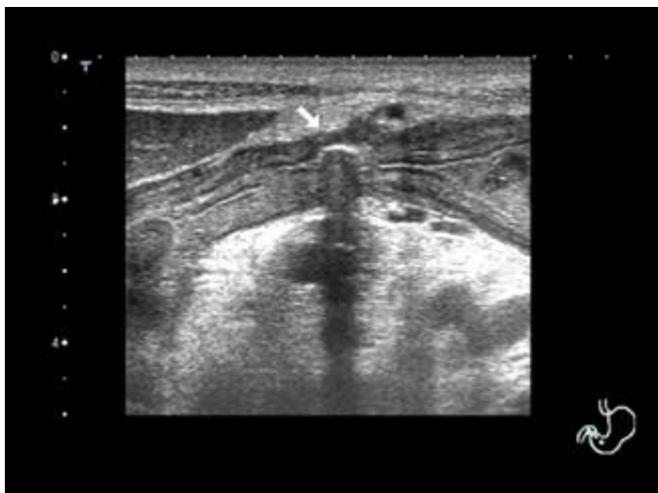

診断名 : 胃潰瘍

使用機種 : 東芝 Aplio XV


周波数 : 7.5 MHz

コメント (術者の一言)

内視鏡検査にて、胃角部小弯に潰瘍があり、小弯短縮による嚢状胃と診断。超音波でも高周波プローブの使用により、小弯部に明瞭な白苔エコーを認め、胃潰瘍と診断できた。

特別賞

岩下 和広 (飯田市立病院)

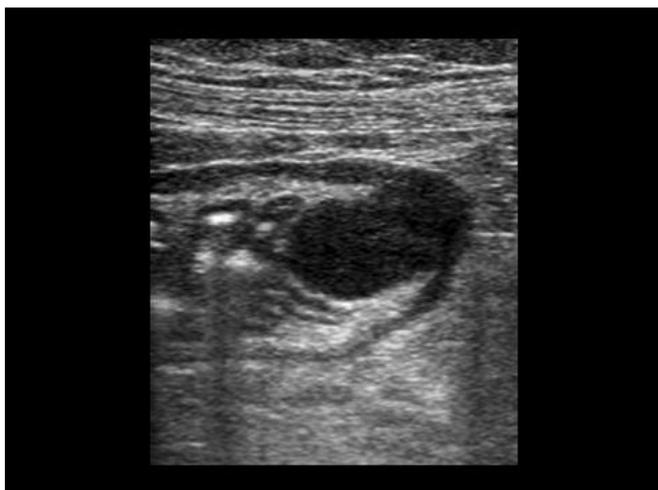

診断名 : 胃粘膜下腫瘍

使用機種 : 東芝 Aplio XV

周波数 : 8.0 MHz

コメント (術者の一言)

飲水法を用いなくても腫瘍と胃壁との関係が明瞭に描出できました。

岡庭賞

竹下 彰 (横浜総合健診センター)



診断名 : 膵管癌

使用機種 : 東芝 Xario XG


周波数 : 3.5 MHz

コメント (術者の一言)

心窩部に当てた瞬間拡張膵管が描出され、腫瘍の存在が確信され予想通り描出された1枚です。

西田賞

滝口 好子 (日本大学駿河台病院)

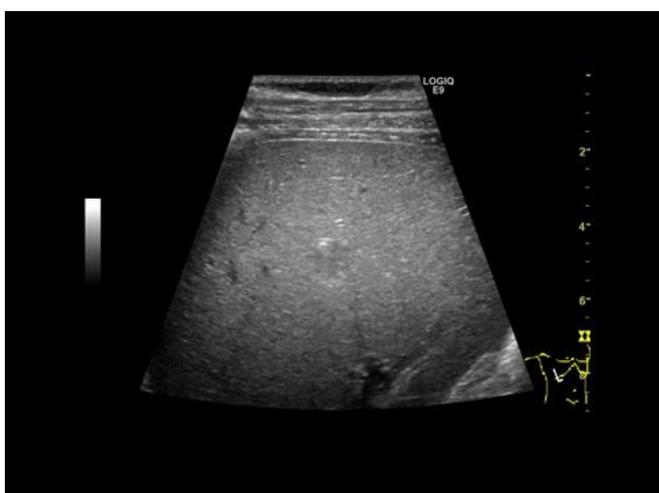

診断名 : C型肝硬変症、肝細胞癌

使用機種 : GE ヘルスケア LOGIQ E9

周波数 : 9.0 MHz

コメント (術者の一言)

中心に認める淡い低エコー腫瘍です。スライドでわかるかが不安です。